


**แผนภาพระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2552**

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา

กระบวนการที่ 1 : การตรวจสอบสารระเหยในวัตถุของกลาง

ระยะเวลาให้บริการ : 18 วัน

ขั้นตอนการให้บริการ

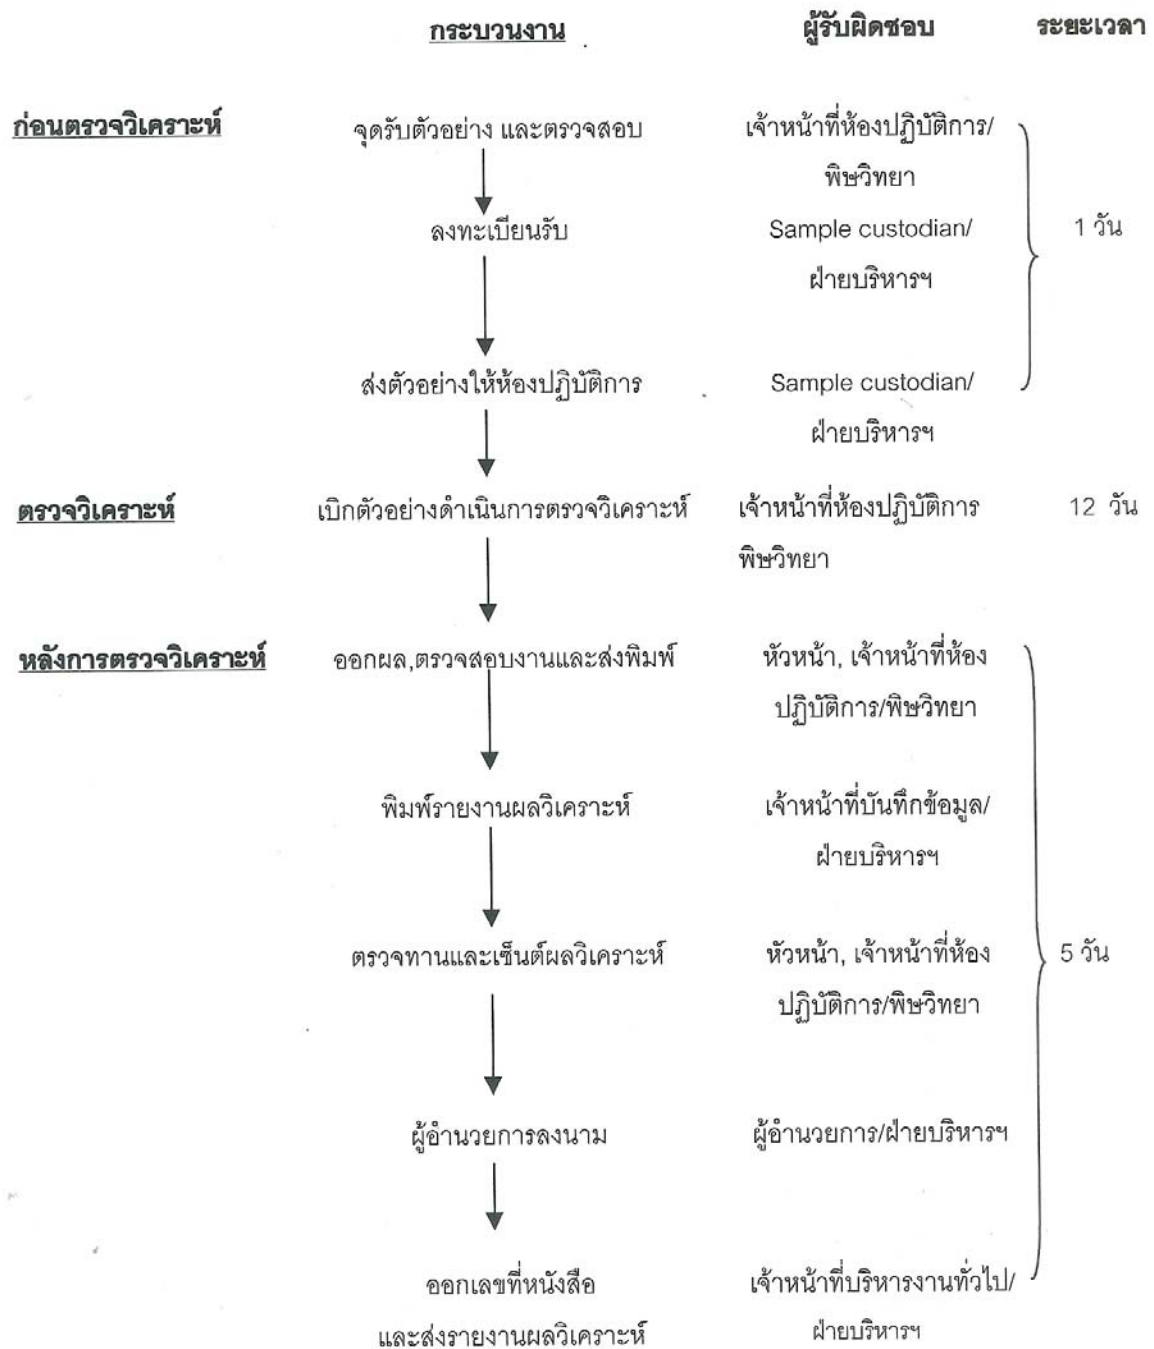

**แผนภาพระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2552**

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา

กระบวนงานที่ 3 : การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องและห้องเอกซเรย์

ระยะเวลาให้บริการ : 50 วัน

ขั้นตอนการให้บริการ : 9 ขั้นตอน

ก่อนตรวจวิเคราะห์

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการให้ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์เป็นเอกสาร

2. นักวิเคราะห์นัดวันออกตรวจสอบ

ตรวจวิเคราะห์

3. นักวิเคราะห์
ตรวจสอบ

หลังตรวจวิเคราะห์

4. Sample custodian ออกหมายเลขวิเคราะห์

5. นักวิเคราะห์ส่งพิมพ์รายงานและตรวจทานผล

6. นักวิเคราะห์เซ็นผล

7. ผอ. ลงนาม

8. ออกหมายเลข

9. ส่งรายงานให้ลูกค้า

**แผนภาพระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2552**

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา

กระบวนการที่ 1 : การตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดปัสสาวะ

ระยะเวลาให้บริการ : 10 วัน

ขั้นตอนการให้บริการ

