

Participant thumbnails and names:

- Admin IT rmsc09 korat
- RMSc 9 Nakorn Ratch...
- PharmDa
- Auyporn Auy
- เรือนยาขุทลนา
- เภสัชกรบรรณ ผู้ชำนาญการ...



Participants (67)

Find a participant

T	Admin IT rmsc09 ... (Host, me)	🔇	🗑️
R9	RMSc 9 Nakorn Ra... (Co-host)	🔇	🗑️
B	Ballang	🔇	🗑️
0๐	002218 อังคณา จิตต์จำเนต	🔇	🗑️
3B	3 B6228613ภูษิต อ่างนโสภา	🔇	🗑️
7	764048	🔇	🗑️
A	Ant	🔇	🗑️
A	Apinya	🔇	🗑️
AA	Auyporn Auy	🔇	🗑️
CT	Chadakam Tinsorn	🔇	🗑️
C	Chalee	🔇	🗑️
CN	Chiradet Nasuk	🔇	🗑️
F	FDABuriram	🔇	🗑️
F	FDABuriram	🔇	🗑️
I	iPhone	🔇	🗑️
IY	iPhone YL	🔇	🗑️

Invite Mute All

Zoom Meeting Control Bar:

- Unmute
- Start Video
- Security
- Participants (67)
- Chat (2)
- Share Screen
- Pause/Stop Recording
- Breakout Rooms
- Reactions
- Apps
- More
- End

Windows Taskbar:

- Ballang
- Downloads
- Microsoft Start - Pr...
- MailGoThai: แฟ้มกั ...
- Zoom
- Zoom Meeting
- 27°C
- 9:31
- 8/9/2564















วิธีการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง

ด้วยชุดทดสอบแอนติเจน

Antigen Test Kit

เตรียมการทดสอบ

- ล้างมือ และใช้ผ้าเช็ดหน้า
- อ่านคำแนะนำการใช้งานในคู่มือที่มากับชุดทดสอบ
- ตรวจสอบวันหมดอายุ

ขั้นตอนการทดสอบ

- ใช้ไม้ swab โพรงจมูก ทั้ง 2 ข้าง มุมข้างละ 5 รอบ
- ใช้ไม้ swab ลงในหลอดที่ป้ายยา

หมุนหลอด อย่างน้อย 5 รอบ แล้วนำออกให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 1: บิดขึ้นตัว C กับ T

แบบที่ 2: ผลลบ (ไม่พบเชื้อ) บิดขึ้นตัว C

แบบที่ 3 และ 4: อ่านผลไม่ได้ ต้องใช้ชุดทดสอบฉบับใหม่

แบบที่ 3: บิดขึ้นตัว T หรือไม่ขึ้นบิตที่ตำแหน่งใดเลย

แบบที่ 4: บิดขึ้นตัว T หรือไม่ขึ้นบิตที่ตำแหน่งใดเลย

5: นำชุดทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ใส่ถุงขยะติดเชื้อ หรือใส่ถุงพลาสติกหนา แล้วมัดปากถุง และทิ้งให้เหมาะสม





วิทยาลัยการสาธารณสุข
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

เปิดใจ ใ้รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล






กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

เปิดใจ ไข้รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

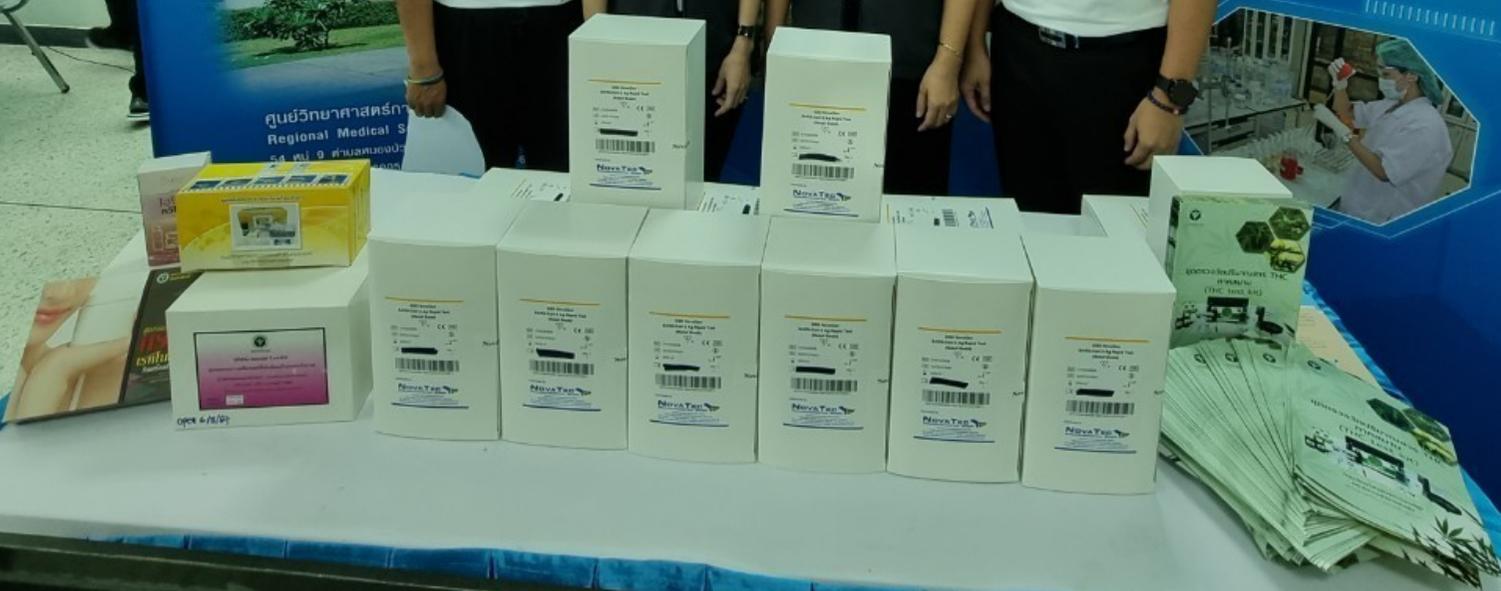

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครราชสีมา

